

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO HOSPITAL MARIO COVAS**

Fundação do ABC - OSS Hospital Estadual Mário Covas	
Proc. nº	3 2 6 / 1 9
Fls.	256

**Ref.: PROCESSO nº 15.326/2019**

A empresa H. Strattner & Cia. Ltda., com sede à Av. Das Águias, 228 – Pedra Branca, Palhoça – Santa Catarina, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 33.250.713/0002-43 e Inscrição Estadual sob. nº 255.588.283, Contato: Camila Rodrigues Telefone: (11) 2185-2300 ramal:3328 E-mail: [cotacoes@strattner.com.br](mailto:cotacoes@strattner.com.br) representada neste ato por sua Analista de Licitações, vem respeitosamente através desta tempestivamente apresentar:

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Pretende esta empresa participar do presente certame licitatório que tem por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de gestão da central de materiais e esterilização (cme) do hospital Mario Covas.

Ao realizar a análise do instrumento convocatório, verificamos que algumas solicitações do edital, necessitam de esclarecimentos, seguem abaixo.

**QUESTIONAMOS/SOLICITAMOS:**

**ANEXO 1** – Descrição dos equipamentos a serem disponibilizados pela contratada em regime de comodato, constam a especificação de marca nos itens, incubadora 490H Marca 3M e AutoClave de baixa temperatura de peróxido, a marca Sterrad.

Para participação de demais empresas no processo, solicitamos a retirada das exigências de marca, já que o mercado possui outras marcas com mesma qualidade, especificações e padrão de qualidade das citadas para atendimento.

Não obstante, é importante ressaltar que a comissão deve licitar os produtos solicitados da forma mais abrangente possível, a fim de buscar a proposta mais vantajosa que atende ao solicitado, em um número maior de licitantes.

**DO PEDIDO**

Diante de todo o exposto, requer a H.Strattner & Cia Ltda., que nosso questionamento seja respondido tempestivamente.



**STRATTNER**

www.strattner.com.br

Pede Deferimento

São Paulo, 14 de agosto 2019.

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas

Proc. nº 13 2 6 7 1 9

Fis. 257

*Camila O. Silva Rodrigues*

**H. STRATTNER E CIA LTDA.**  
Camila de Oliveira Silva Rodrigues  
Assistente de Licitações  
RG 44.100.977-3 -SSP  
CPF 352.618.408-99

**33.250.713/0002-43**  
**H. STRATTNER & CIA LTDA**

Avenida das Águias, 228

Cid. Univ. Pedra Branca - CEP 88.137-280  
PALHOCA - SC

ESTRADA  
S/N - PALHOCA - SC

Unidade: Hospital Estadual  
Hospital Estadual Mário Covas  
Rua das Águias, 228  
Cidade Universitária Pedra Branca  
Palhoça - SC

H. STRATTNER E CIA LTDA  
Rua das Águias, 228  
Cidade Universitária Pedra Branca  
Palhoça - SC

Contato  
Telefone: (47) 3323-5000

E-mail: atendimento@strattner.com.br

Site: www.strattner.com.br



FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS



Santo André, 20 de Agosto de 2019.

**Ref.: Atendimento ao Pedido de Esclarecimento**

Conforme as questões em que foram solicitados esclarecimentos pela empresa H. Strattner & Cia Ltda, segue as seguintes respostas:

**ANEXO 1- Descrição dos equipamentos a serem disponibilizados pela contratada em regime de comodato, constam a especificação de marca nos itens, Incubadora 490H Marca 3M E Autoclave de baixa temperatura de peróxido, a marca Sterrad.**

Com relação ao questionamento sobre o ANEXO I, não é necessário considerar nenhuma marca específica, por isso solicitamos que seja retificado o ANEXO I do Termo de Referência, conforme anexo.

Atenciosamente,

**Profª Maria Elisa Ravagnani Gonçalves Ramos**  
Diretora de Enfermagem – HEMC

**Ariadne de Paula Nascimento**  
Supervisora de Enfermagem



FUNDAÇÃO DO ABC  
Desde 1967



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS



## ANEXO I

### DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA EM REGIME DE COMODATO

#### **INCUBADORA**

Altura Métrica	8,255 cm
Comprimento	8,75 Polegadas, 22,225 cm
Largura	8,75 Polegadas, 22,225 cm
Método de Esterilização	Hydrogen Peroxide
Modelo	490H
Profundidade Métrica	22,86 cm

#### **Seladora de Plástico**

Tensão de Alimentação – 220 v. ou 110 v. (Não é Bivolt). 50/60HZ  
Potência - 280 W.  
Peso Líquido – 11 kg  
Peso Bruto – 12 Kg  
Dimensões da Seladora – 380mm x 310mm x 180 mm  
Dimensões da Embalagem – 450mm x 400mm x 230 mm

#### **Seladora Automática de Grau Cirúrgico**

Tensão de Alimentação – 220 v. 50/60HZ  
Potência 280 Watts  
Peso Líquido – 12,5 kg - Peso Bruto – 13 Kg  
Dimensões da Seladora – 440mm x 280mm x 160 mm  
Dimensões da Embalagem – 490mm x 320mm x 220 mm

### INCUBADORA

Tensão de Alimentação – 100 – 240 V. 50/60HZ  
Potência 28 W Watts  
Peso Líquido – 1.92 Kg  
Dimensões da Incubadora – 18.0 cm de altura, 26.0 cm de diâmetro.  
Peso 1,92 kg

### Autoclave de Baixa Temperatura por Peróxido de Hidrogênio

Dimensões 15,7 x 32 x 60 cm  
Peso 125 kg  
Peso com carrinho 187 kg  
Voltagem 220V  
Potencia 5kva  
Amperagem 23 A  
Temperatura ambiente 18 a 35 C°

### TUNEL DE SECAGEM

Voltagem: 220v – monofásico.  
Pirômetro digital/ medidor de temperatura: Temperatura média de 120 a 150° graus.  
Velocidade da esteira: Pode variar de acordo com a necessidade do produto/ cliente.  
Largura máxima do produto: 420 mm (modelo 45 x 25);  
Altura máxima do produto: 230 mm;  
Potência das resistências: 6.000 watts;  
Potência total: 6.500 watts;  
Consumo: 6,5 kwh;

### BOMBA SMART JET

Alimentação 110V ou 220V AC  $\pm$  10% 50/60 Hz  
Corrente 20 A (110V) / 10 A (220V)  
Campo de Intervenção 1 à 3,5 bar  
Pressão máxima admissível 10 bar  
Temperatura máxima do líquido 60°C  
Vazão máxima 8m<sup>3</sup>/h  
Grau de proteção IP 65  
Peso 0,325 kg  
Rosca  
Entrada: 3/4" BSP  
Saída: 1" BS






FUNDAÇÃO DO ABC  
Desde 1967



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS

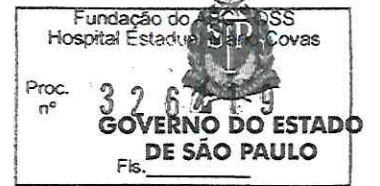

## OSMOSE REVERSA

Pressão de trabalho 6,0 Kgf/cm<sup>2</sup>

Alimentação da fonte 220v – 240v 50/60 Hz

Consumo de Energia 20,60 Kwh/mês

Dimensões da caixa 600x500x250 mm

Peso 60 Kg

Tanque 100L

Qtd. De membranas 4

Descarte de água 20,9 litros/hora.