



PROC. Nome Desiral de FLS 03

Mogi das Cruzes, 07 de janeiro de 2021.

Ofício Compras n.º 19/2021

À
FUABC – CENTRAL DE CONVÊNIOS
Sr. Fernando G. Minciotti
Diretoria Administrativa

Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HMMC

Solicitamos a FUABC- Central de Convênios, pedido de compra de material médico hospitalar – CME O respectivo item é necessário para manutenção de nosso estoque pelo período de 30 (trinta) dias, tendo em vista a necessidade de avaliação diária de consumo face ao perfil dos pacientes internados na instituição.

É importante ressaltar que os <u>produtos deverão</u> <u>ser das marcas especificadas nos pedidos</u>, tendo vista a certificação destas marcas para uso no <u>CME</u>, conforme demonstrado no Relatório de Qualificação dos Equipamentos na Central de Materiais Esterilizados, anexo a este documento

Considerando que o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, tornou-se referência para atendimento aos pacientes portadores de COVID 19, e hoje conta com 50 (sessenta) leitos de enfermaria e, respectivamente, 44 (trinta e quatro) em UTI. Entretanto, diante da demanda há possibilidade de remanejo de leitos enfermaria para UTI.

Somado a tal fato, a média de permanência dos pacientes internados em enfermaria é de 6.56 (dias) e, respectivamente, 10.47 (dias) em UTI, logo seu perfil de atendimento está totalmente voltado para a pandemia impactando substancialmente no quantitativo de materiais médico hospitalar em nosso estoque.


Neste sentido, foi providenciado a solicitação de compra para o abastecimento pelo período de 30 (trinta) dias, levando em consideração o consumo médio mensal apurado nos relatórios SOULMV - Sistema de Gerenciamento de Compras e SOULMV - Sistema Controle de Estoque.



- CEP: 08740-320 MOGI DA







É importante ressaltar que estes <u>itens se encontram zerados em nosso estoque</u>, por conta do aumento da demanda de atendimento, conforme demonstrado nos quadros anexos, cujos dados serviram como base para a elaboração deste pedido.

O valor estimado para presente aquisição importará um total de R\$ 8.931,75 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) tendo como base os valores praticados na última compra, extraídos do sistema MV.

A despesa deverá onerar o Contrato de Gestão n.º 58/2019- Fundação do ABC.

Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria os devidos encaminhamentos.

Atenciosamente,

Décio Teixeira Prates Júnior

Diretor Regional

- Mogi das Cruzes

Heloisa Molinari Calderon Nascimento Diretora Geral Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Fernando G. Minciotti Diretor Administrativo FUABC - Central de Convenios









Página: 1 / 1 Emitido por: ELENIR.ABREU

Em: 06/01/2021 14:07

Competência de 09/2020 até 01/2021, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

	Γ	09/2020		10/2020		11/2020	
Produto	Unidade	Qtd. Mvto	VIr. Mvto	Qtd. Mvto	VIr. Myto	Qtd. Mvto	Vir. Myte
24588 Acido Peracetico 0,09% A 0,15%-Sol. Prnt P/ Uso -	Galao	10,00	3.875,78	1,00	387,58		
5lt Anios							_
27949 Acido Peracetico 0,2% Lab News	Frasco						
26198 Canula Traqueostomia Metalica N°4	Unidade					2,00	72,64
26197 Canula Traqueostomia Metalica N°5	Unidade	3,00	96,00			5,00	159,9
28222 Fio Guia P/ Entubação Bougie	Unidade					5,00	142,5
24095 Indicador Químico 1233 Bowie Dick-3m	Pacote	6,00	100,83				
26289 Lubrificante Para Instrumentais Cirurgicos - 11	Galao	1,00	68,00				
24177 Solução Peroxido De Hidrogenio 50% - Ref. M0600	Frasco	1,00	120,00	1,00	120,00		
150							
23092 Tubo Silicone Incolor Ref 204 6,00mmx12,00mm	Ünidade	15,00	162,24	1,00	107,00	3,00	341,5

		12/2020		
Produto	Unidade	Qtd. Myto	Vir. Myto	* Média Qtd.
24588 Acido Peracetico 0,09% A 0,15%-Sol. Prnt P/ Uso - 5lt Anios	Galao		·	5,50
27949 Acido Peracetico 0,2% Lab News	Frasco	6,00	1,033,89	
26198 Canula Traqueostomia Metalica N°4	Unidade			2,00
26197 Canula Traqueostomia Metalica N°5	Unidade			4,00
28222 Fio Guia P/ Entubacao Bougie	Unidade	5,00	146,60	
24095 Indicador Quimico 1233 Bowie Dick-3m	Pacote	112,00	1.882,22	59,00
26289 Lubrificante Para Instrumentais Cirurgicos - 11	Galao			1,00
24177 Solucao Peroxido De Hidrogenio 50% - Ref. M0600- 150	Frasco	2,00	240,00	1,33
23092 Tubo Silicone Incolor Ref 204 6,00mmx12,00mm	Unidade			6,33

<sup>\*</sup> Obs.: O calculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houveram movimentações. (MÉDIA ARITIMÉTRICA)

Página: 1 / 1
Emitido por: ELENIR.ABREU
Em: 06/01/2021 14:07

Competência de 09/2020 até 01/2021, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto Controlado: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

		09/2020		10/2020		11/2020	
Produto	Unidade	Qtd. Mvto	Vir. Myto	Qtd. Mvto	Vir. Mvto	Qtd. Mvto	Vir. Myte
24588 Acido Peracetico 0,09% A 0,15%-Sol. Prnt P/ Uso - 5lt Anios	Galao	10,00	3.875,78	1,00	387,58		
27949 Acido Peracetico 0,2% Lab News	Frasco	····					
26198 Canula Traqueostomia Metalica N°4	Unidade					2,00	72,64
26197 Canula Traqueostomia Metalica N°5	Unidade	3,00	96,00			5,00	159,99
28222 Fio Guia P/ Entubacao Bougle	Unidade					5,00	142,50
24095 Indicador Químico 1233 Bowie Dick-3m	Pacote	6,00	100,83				
26289 Lubrificante Para Instrumentais Cirurgicos - 11	Galao	1,00	68,00	i i			
24177 Solucao Peroxido De Hidrogenio 50% - Ref. M0600- 150	Frasco	1,00	120,00	1,00	120,00		
23092 Tubo Silicone Incolor Ref 204 6,00mmx12,00mm	Unidade	15,00	162,24	1,00	107,00	3,00	341,50


		12/2020		
Produto	Unidade	Qtd. Mvto	VIr. Mvto	* Média Qtd.
24588 Acido Peracetico 0,09% A 0,15%-Sol. Prnt P/ Uso - 5lt Anios	Galao			5,50
27949 Acido Peracetico 0,2% Lab News	Frasco	6,00	1.033,89	
26198 Canula Traqueostomia Metalica N°4	Unidade			. 2,00
26197 Canula Traqueostomia Metalica N°5	Unidade			4,00
28222 Fio Guia P/ Entubacao Bougie	Unidade	5,00	146,60	5,00
24095 Indicador Quimico 1233 Bowie Dick-3m	Pacote	112,00	1.882,22	59,00
26289 Lubrificante Para Instrumentais Cirurgicos - 11	Galao			1,00
24177 Solucao Peroxido De Hidrogenio 50% - Ref. M0600- 150	Frasco	2,00	240,00	1,33
23092 Tubo Silicone Incolor Ref 204 6,00mmx12,00mm	Unidade			6,33

<sup>\*</sup> Obs.: O calculo da média deste relatório é feito com base nos meses que houveram movimentações. (MÉDIA ARITIMÉTRICA)

POSIÇÃO DE ESTOQUE DE VALOR VALOR OBCS **PEDIDO** DESCRIÇÃO. Unidade: CMM PEDIDO. ESTOQUE **SEGURANCA** LINIT TOTAL 7018-6473 MARCA DEVE ESTAR DE ACORDO 11 COM O RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO 4.730.00 430 Acido Peracetico 0.09% A 0.15%-Sol. Prnt P/ Uso - 5lt Anios Galao 5 \ MARCA DEVE ESTAR DE ACORDO 20338696 COM O RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO Acido Peracetico 0.2% Lab News 1.301.67 3 144,63 27949 Frasco 6 0 70336227 Fio Guia P/ Entubação Bougie 5 5 29.32 293,20 28222 Unidade MARCA DEVE ESTAR DE ACORDO 7033-2655 Indicador Quimico 1233 Bowie Dick-3m 118 COM O RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO 1.777.08 59 59 15.06 24095 Pacote PREFERENCIALMENTE DA LAB NEWS (NECESSÁRIO TER REGISTRO NA ANVISA).CASO NÃO SEJA ESTA MARCA SUBMETER O PRODUTO PARA Lubrificante Para Instrumentais Cirurgicos - 11 Galao JAPROVAÇÃO. 68.00 136.00 MARCA DEVE ESTAR DE ACORDO COM O RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO 120 480.00 Solução Peroxido De Hidrogenio 50% - Ref. M0600-150 Frasco Tubo Silicone Incolor Ref 204 6.00mmx12.00mm 7033 7006 Unidade 6 12--> 6 n 26198 Canula Traqueostomia Metalica N°4 - 2033 - 62 UL Unidade 2 0 0 35,7 71,40 26197 Canula Traqueostomia Metalica N°5 - 2022 35.6 142,40 4 n 0 4× Unidade 8.931,75 TOTAL

<del>1</del>48

PROC. N° MYNCH DIONEILAIN
FLS 07
VISTO



PROC. No mch0018101

PROC. No mch0018101

WISTO

FUNDAÇÃO DO AL

De acordo com legislação RDC 15 RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012, a qual determina os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde, em seu Art. 37 estabelece que deve ser realizada qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho, para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para saúde, com periodicidade mínima anual.

Entre os dias 14 a 18 de outubro de 2019, passamos pelo processo de qualificação de Instalação e Operação e, entre os dias 21 a 31 de outubro por qualificação de desempenho dos seguintes equipamentos:

- ✓ Termodesinfectadora;
- Autoclave a Vapor saturado sob pressão TAG 198;
- ✓ Autoclave a Vapor saturado sob pressão TAG 199;
- ✓ Gabinete de secagem;
- ✓ Autoclave Plasma Peróxido de hidrogênio;

Em conformidade com os respectivos equipamentos, foram qualificados os seguintes insumos:

## Termodesinfectadora

Teste de Limpeza: Valisafe CEI, GKE Clean -Record WD YELLOW, GKE Clean -Record US YELLOW, TOSI Lumcheck;

Detergentes enzimáticos: Aniosyme synergy 5 e 3M 5 enzimas;





## Relatório de Qualificação dos Equipamentos n<u>a Cent</u> Materiais Esterilizados



100 mg 2018/21

### Autoclaves a Vapor saturado sob pressão

Indicadores Químicos: GKE Steri-Record TIPO 5 STEAM, KIMS TIPO 5 STEAM, 3M COMPLY 1243;

Pacote desafio com indicador biológico e químico 3M ATTEST TIPO 5 STEAM:

Pacote desafio GKE para indicador químico, biológico (individuais);

Indicadores Biológicos: 3M ATTEST 1292, 3M ATTEST 1492, GKE Steri-Record;

Indicador Bowie Dick Pacotes desafio: 3M COMPLY 1233LF BR, KIMS 7Kg 4500CF2219, GKE 4 Kg;

### Autoclave Plama peróxido de hidrogênio

Indicadores Químicos: Gke Steri- Record tipo 4, 3M COMPLY 1248, Chemdye VH202 tipo 1;

Indicadores Biológicos: Tecil HPB020-H2O2, GKE Steri- record, 3M ATTEST1295 VH2020.

Solução Peróxido de hidrogênio 50% BAUMER.

### Seladora

Teste de uniformidade da qualidade da selagem Seal Check BR;

## Conforme resolução, segue anexo para maiores informações

A qualificação dos equipamentos do CME são determinadas pela legislação RDC 15 de 12 de março de 2012:



# Relatório de Qualificação dos Equipamentos na ( Materiais Esterilizados



Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

XXII - qualificação da instalação: evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento foi entregue e instalado de acordo com as suas especificações;

XXIII - qualificação de operação: evidência documentada, fornecida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento, após a qualificação da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação;


XXIV - qualificação de desempenho: evidência documentada de que o equipamento, após as qualificações de instalação e operação, apresenta desempenho consistente por no mínimo 03 ciclos sucessivos do processo, com parâmetros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio, determinada pelo serviço de saúde;

Art. 37 Deve ser realizada qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho, para os equipamentos utilizados na limpeza automatizada e na esterilização de produtos para saúde, com períodicidade mínima anual.

Parágrafo único. Sempre que a carga de esterilização apresentar desafios superiores àquela utilizada na qualificação de desempenho, esta qualificação deve ser refeita.

Referências - RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012

Estes artigos acima informam que a qualificação deve ser realizada anualmente, e que diante de produtos ou insumos não utilizados durante o processo de qualificação, não estarão validados quanto a esterilização, em possíveis processos de infecção movidos por pacientes, procedimentos de investigação de prontuário entre outros, visto que a comprovação não será efetiva. Durante a qualificação os parâmetros são ajustados. Desta forma não podemos alterar os parâmetros dos equipamentos a um produto não validado.




FUNDAÇÃO DO AI

Risco: Se utilizarmos produtos não validados, não comprovamos o método de esterilização e limpeza. Outro risco é de inspeção da vigilância sanitária estadual (autuação), visto que é solicitado a documentação da qualificação do equipamento e os insumos descritos na qualificação de desempenho, estando dispostos na CME.

Aline Luzia Oliveira Alves Loiola Corey SP 589146- Enf


Enfermeira Aline Loiola

Cordenadora Patricia Couto

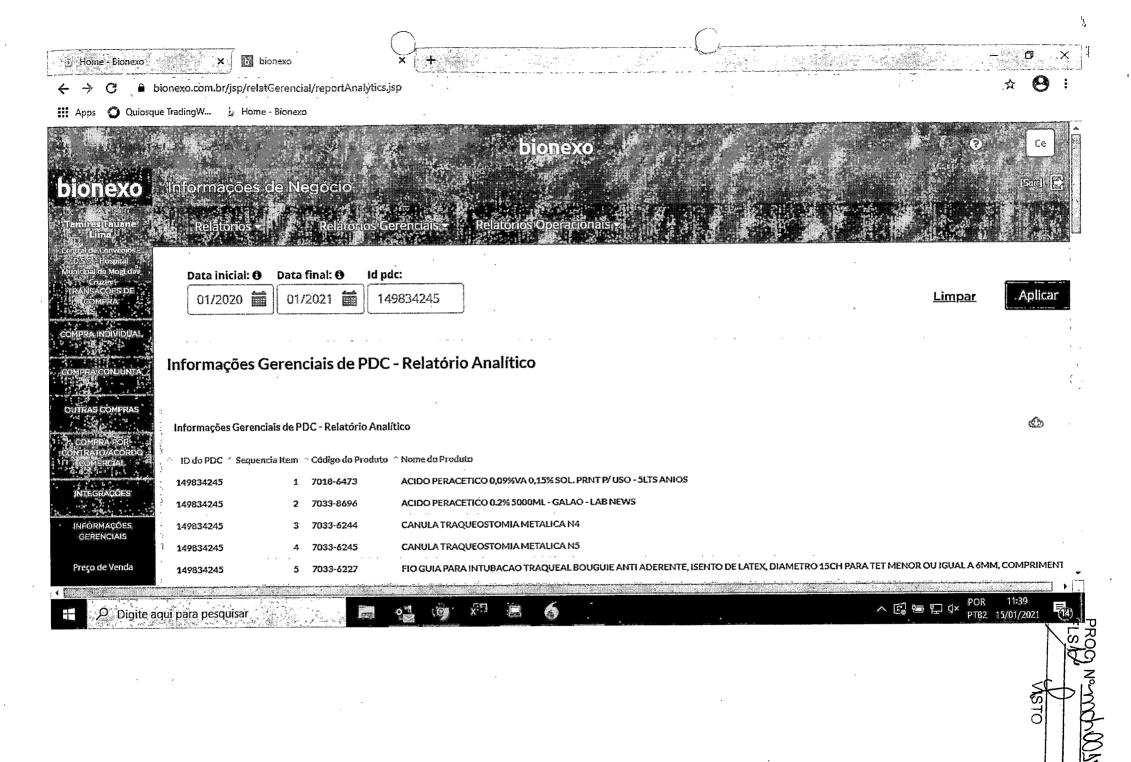

Google CANULA	TRAQUEOSTOMIA METALICA N4	× ; • • • •	. Fazar login
Até RS 50  R\$ 50 - R\$ 100  R\$ 100 - R\$ 300  Acima de R\$ 300  R\$ até R\$ IR		Canula Traqueostomia Metal Stylle (4(0,10mm)-Standard)  R\$ 71,09 Magazine Médica 95% positivos (1.802)  Cânula para Traqueostomia Metal Stylle Standard tamanho 4(0,10mm)	E
Vendedor  Americanas.com  Ballke Produtos Para  Magazine Médica  Mercado Livre  Pontofrio.com  MAIS		Cânula Para Traqueostomia Metálica Standard N.4 <b>R\$ 84,00</b> Americanas.com  A cânula para traqueostomia Stylle é indicada para: - Aliviar obstruções das vias aèreas	s superiores; - Suporte ventilatório
		Cânula de Traqueostomia Metálica - Fradel NRo02  R\$ 85,36 Hospitalar Distribuidora  Confeccionada em metal cromado, sem rebarbas ou sinais de oxídação, jogo composto p	por 03 peças sendo: 01 mandril com ponta

CONOMICOUS BOLL

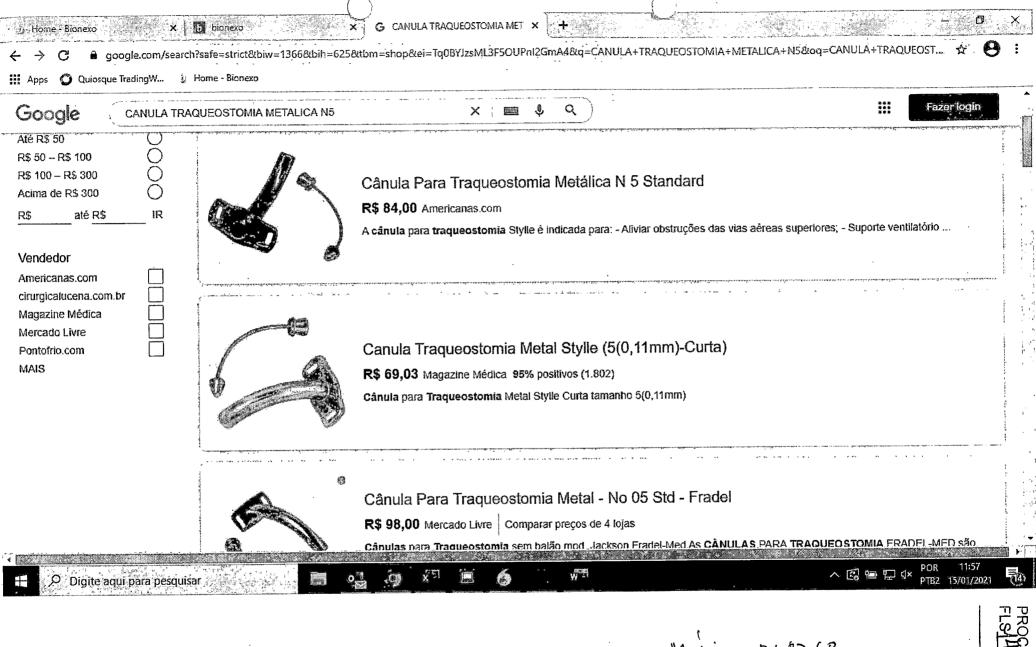

Media = R8 83, 68




# ESTIMATIVA - PROCESSO MCH0018/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - CME - HMMC

pdc id	item	código	produto nome	unidade medida	data abertura	data fechamento	qtde venda	preço unit	, 	oreço total
149834245	1	7018-6473	ACIDO PERACETICO 0,09%VA 0,15% SOL. PRNT P/ USO - 5LTS ANIOS	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	11	R\$ 535,50	R\$	5.890,50
149834245	2	7033-8696	ACIDO PERACETICO 0.2% 5000ML - GALAO - LAB NEWS	Galao	14/01/2021	20/01/2021	29-	R\$ 338,00	R\$	3.042,00
149834245	3	7033-6244	CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N4	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	32	R\$ 80,15	R\$	160,30
149834245	4	7033-6245	CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N5	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	y 4 -	R\$ 83,68	R\$	334,71
149834245	5	7033-6227	FIO GUIA PARA INTUBACAO TRAQUEAL BOUGUIE ANTI ADERENTE, ISENTO DE LATEX, DIAMETRO 15CH PARA TET MENOR OU IGUAL A 6MM, COMPRIMENTO 70CM	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	<sup>5</sup> 10	R\$ 29,32	R\$	293,20
149834245	6	7033-2655	200 DOWNER DION 2014	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	6 118-	R\$ 12,00	R\$	1.416,00
149834245		7033-0708	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 1LT	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	22/	R\$ 49,50	R\$	99,00
149834245		7018-6806	SOLUCAO PEROXIDO DE HIDROGENIO 50% - UNIDADE REF M0600-150	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	0 4 <del>-</del>	R\$ 120,00	R\$	480,00
149834245	9	7033-0063	TUBO DE SILICONE INCOLOR 15M REF 204 6,00MM X 12,00MM	Unidade	14/01/2021	20/01/2021	G1 <sub>12</sub>	R\$ 8,50	R\$	102,00
<u> </u>					valo	or total da	estima	tiva		11.817,71

Tamires T. Lutter
Departamento de Compras
Central de Convênios

15/01/21



01/02/2021 Bionexo

# bionexo

Bionexo do Brasil Ltda Relatório emitido em 01/02/2021 10:52

### Comprador

Fundação do ABC - Central de Convênios - O.S.S. - Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (57.571.275/0004-45)

Rua Guttermann, 577 - - MOGI DAS CRUZES, SP CEP: 08740-320

### Relatório de Volume de Compras por Fornecedor (Itens Confirmados)

Pedido de Cotação: 149834245

PROCESSO MCH0018/21 - AQUISIÇÃO DE MAT MED HOSP - CME - HMMC

Tipo de Cotação: Cotação para entrega programada

	<u>Fornecedor</u>	Qtd.Itens	<u>Volume Total</u>
1	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda  AL AFRICA 570 , SÃO PAULO - SP  Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544  informatica1@cfernandes.com.br  Mais informações	1	<u>R\$ 307,70</u>
2	De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda  Rua São Francisco do Vermelho, 90 - , SÃO PAULO - SP  Leticia Guedes Teixeira Da Silva - (11) 2621-8884  bionexo.depauli@terra.com.br  Mais informações	<u>3</u>	<u>R\$ 1.793,46</u>
3	Grow Quimica e Farmaceutica Ltda  Avenida Vitória Rossi Martini, 648 - Vitoria Martini , INDAIATUBA - SP  Celma Mota - (19) 39359696  celma.mota@growqf.com.br  Mais informações	1	<u>R\$ 1.247,16</u>
4	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda EST SAMUEL AIZEMBERG, 1100 , SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Webservice Soma Sp - (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br Mais informações	1	R\$ 2.589,60
То	tal	<u>6</u>	R\$ 5.937,92

Fornecedores que responderam a cotação: 22

Fornecedores que venderam: 4

**%:** 18%

imprimir voltar